


1

Po implantacji


Użyj klucza 1.25 mm

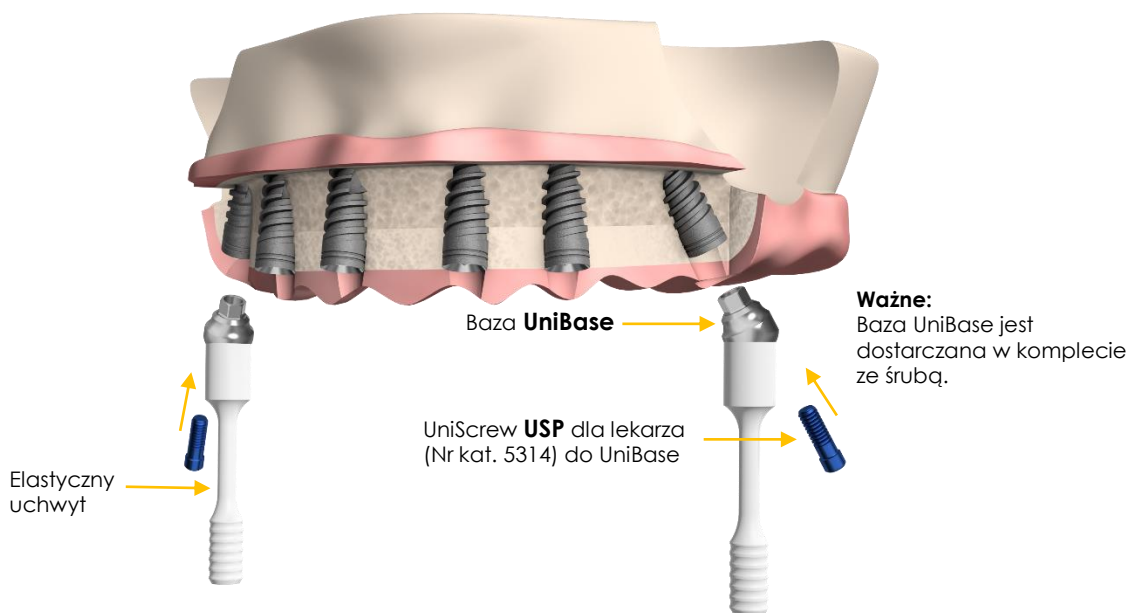

2

Założenie filarów

Użyj klucza 1.5 mm

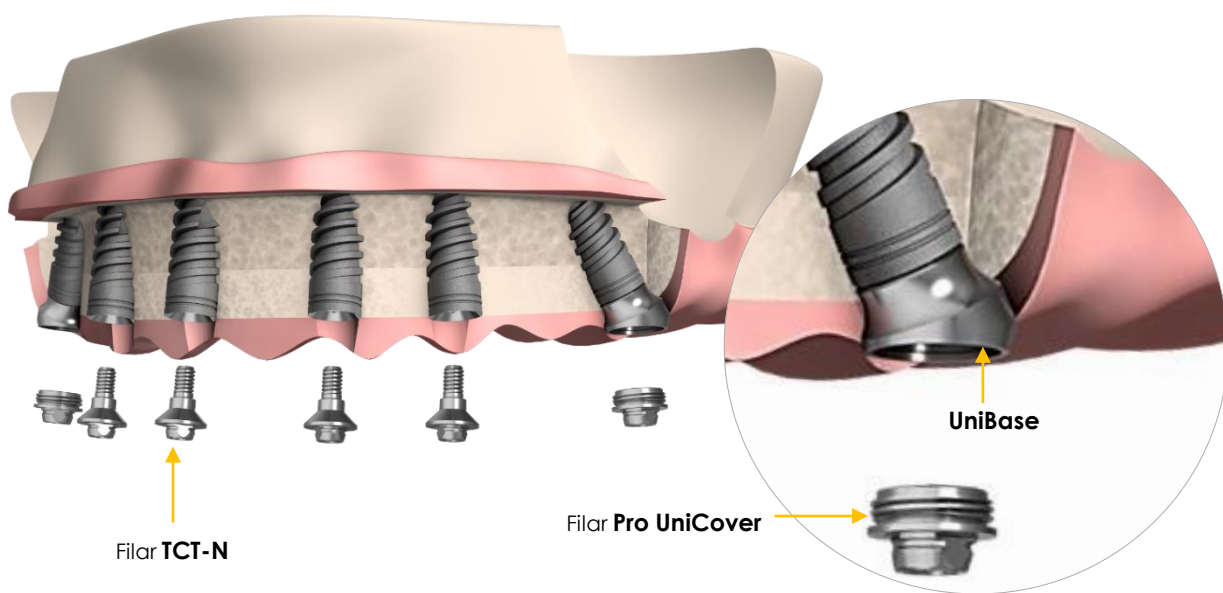


- Użyj klucza 1.25 mm
- Użyj klucza 1.5 mm

Alpha Universe Multi Unit Etapy Pracy

3 Przygotowanie wycisku z poziomu filara


Użyj klucza 1.25 mm

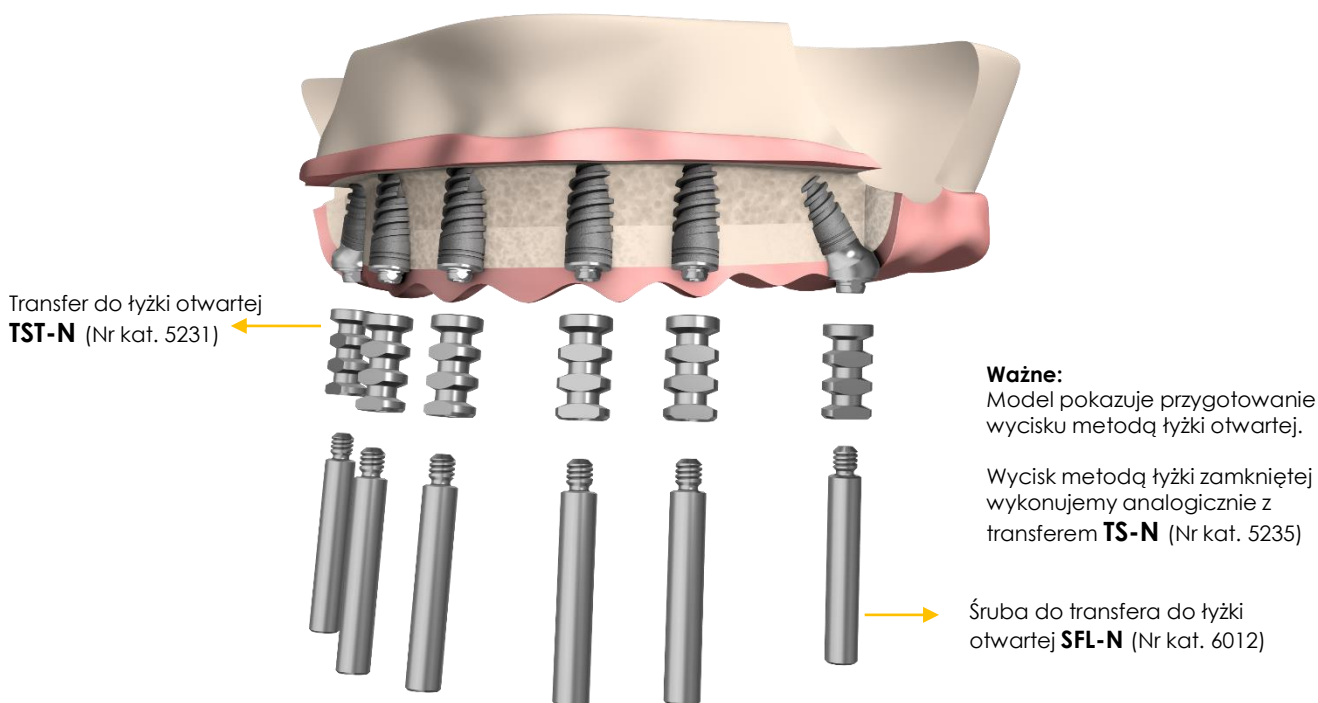

4 Wycisk metodą łyżki otwartej

Wycisk metodą łyżki zamkniętej wykonujemy analogicznie.

Użyj klucza 1.25 mm

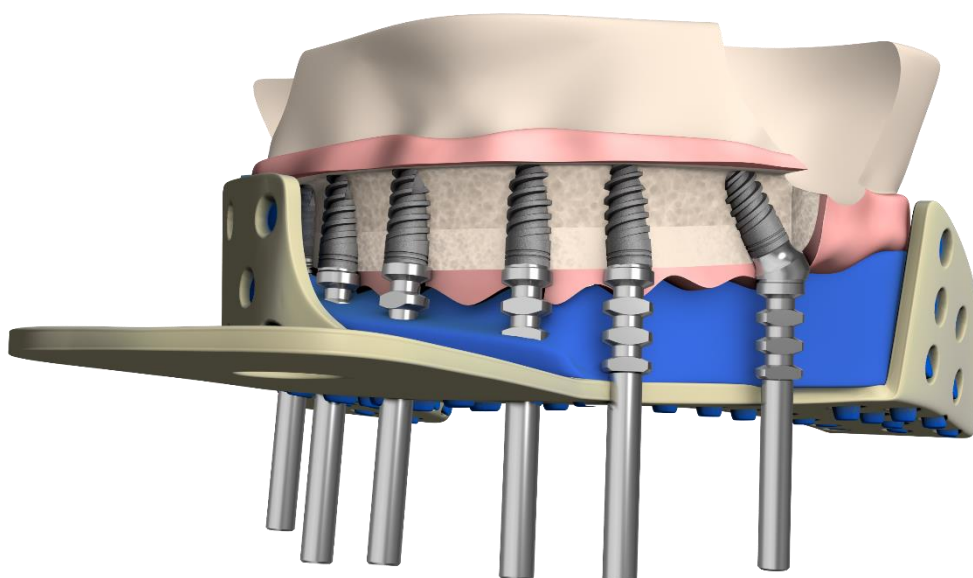


Użyj klucza 1.25 mm
 Użyj klucza 1.5 mm

Alpha Universe Multi Unit Etapy Pracy


5 Wykonanie modelu z analogami

Użyj klucza 1.25 mm

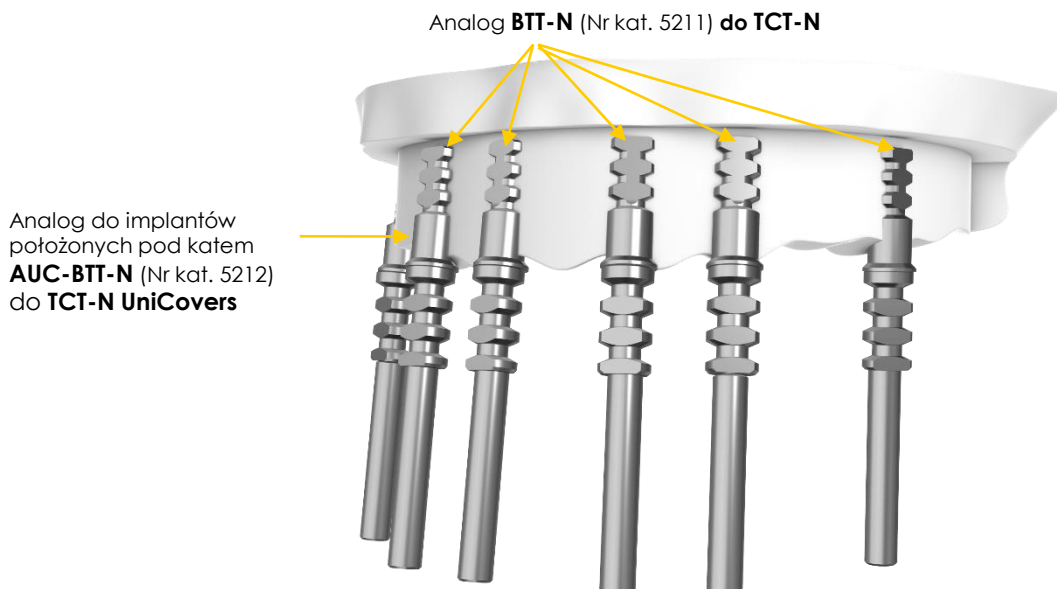

6 Modelowanie konstrukcji

Użyj klucza 1.25 mm

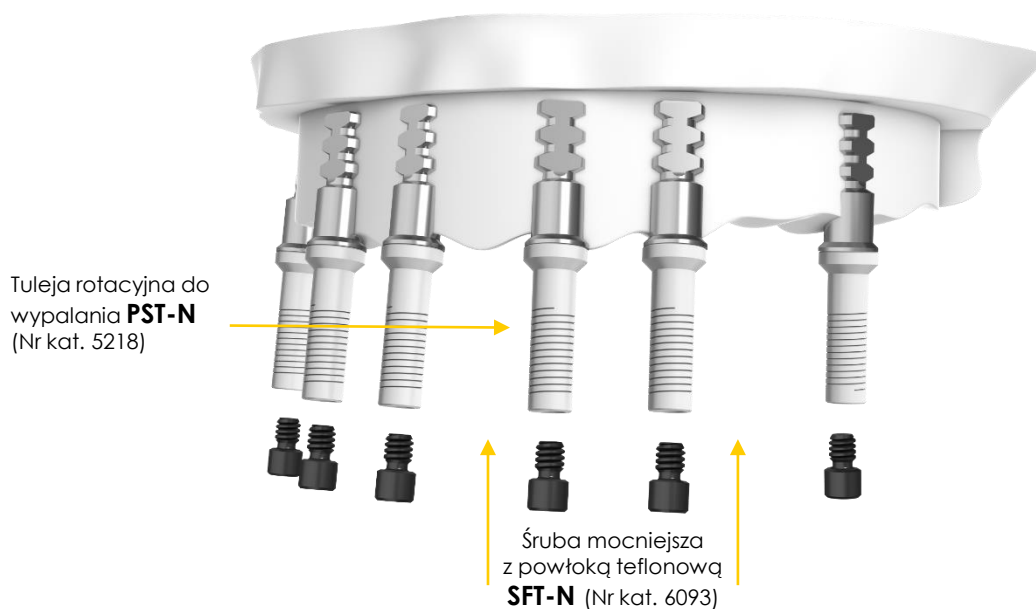

Użyj klucza 1.25 mm

Użyj klucza 1.5 mm


Zdjęcia na stronie służą jedynie celom poglądowym.

Alpha Universe Multi Unit Etapy Pracy

7

Odlew metalu

Użyj klucza 1.25 mm

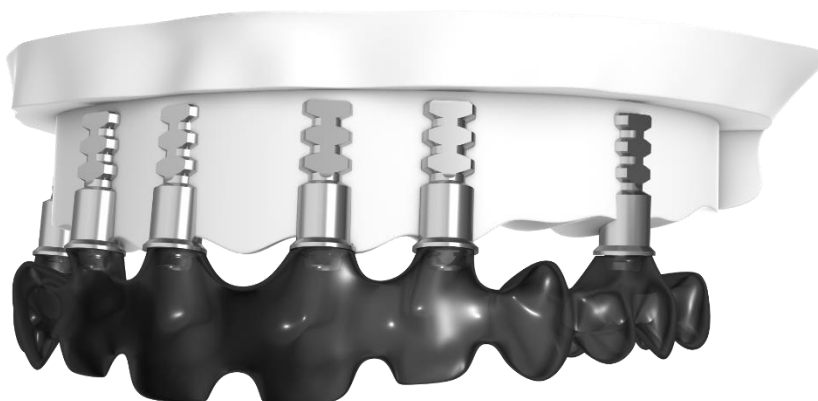


Śruba mocniejsza z powłoką teflonową
SFT-N (Nr kat. 6093)

8

Sprawdzenie dopasowania konstrukcji

Użyj klucza 1.25 mm

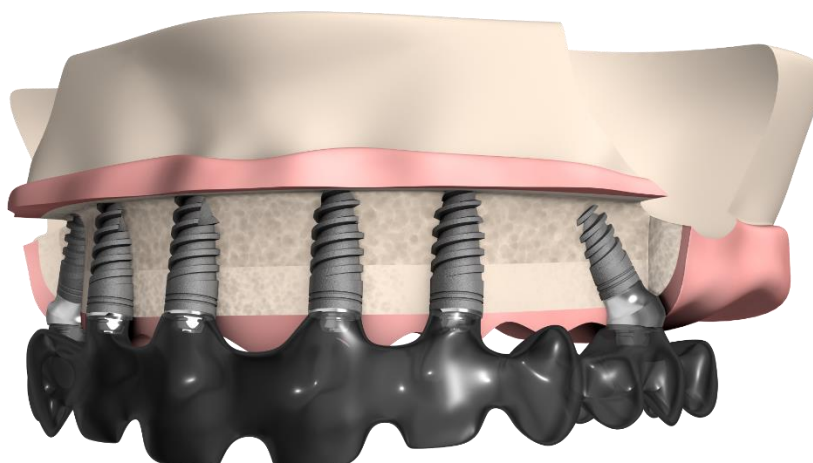

Śruba tytanowa
SF-N (Nr kat. 6092)

- Użyj klucza 1.25 mm
- Użyj klucza 1.5 mm


Zdjęcia na stronie służą jedynie celom poglądowym.

Alpha Universe Multi Unit Etapy Pracy

9

Olicowanie uzupełnienia

Użyj klucza 1.25 mm

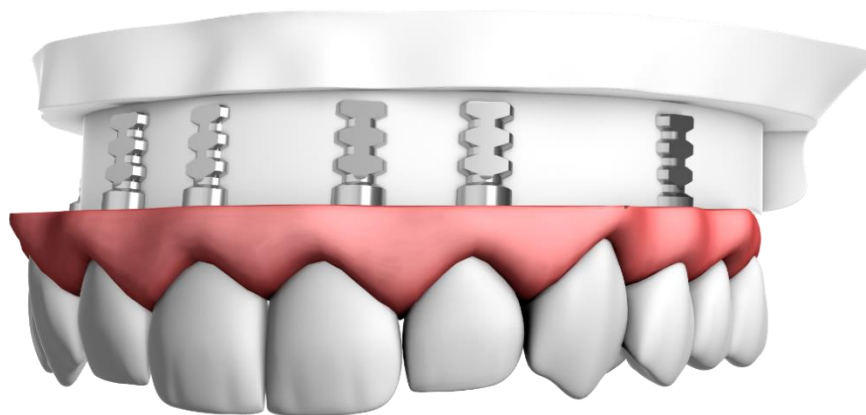


Śruba mocniejsza
z powłoką teflonową
SFT-N (Nr kat. 6093)

10


Zamontowanie odbudowy

Użyj klucza 1.25 mm

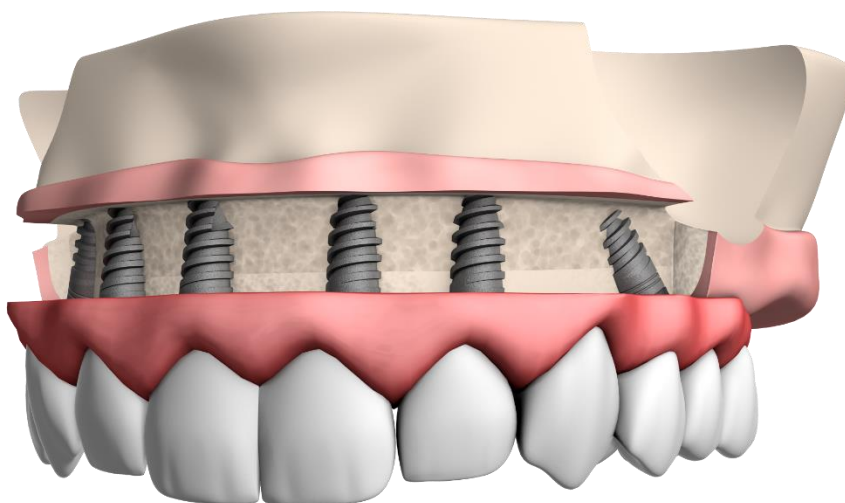

Śruba tytanowa
SF-N (Nr kat. 6092)

 Użyj klucza 1.25 mm

 Użyj klucza 1.5 mm


Zdjęcia na stronie służą jedynie celom poglądowym.


Alpha Universe Multi Unit **Etapy Pracy**

11

Sily przykręcania przy użyciu klucza dynamometrycznego

UniBase do implantu	30 Ncm
UniCover do UniBase	30 Ncm
Tymczasowe elementy tytanowe do UniCover	15 Ncm
Nasadka plastikowa do odlewu do UniCover	- tylko ręcznie - bez użycia narzędzi
Transfer do UniCover	tylko ręcznie - bez użycia narzędzi
Śruba gojąca do UniCover	10 Ncm
Praca końcowa do filara prostego	25 Ncm

 Użyj klucza 1.25 mm

 Użyj klucza 1.5 mm

Zdjęcia na stronie służą jedynie celom poglądowym.