




## Chirurgiczny Protokół Nawiercania

ARRC – stosowany do wszystkich typów kości typu D1 D,2 D3 i D4



AlphaBio<sup>tec</sup>  
Implantology


Kolejność zastosowania **Wiertel**

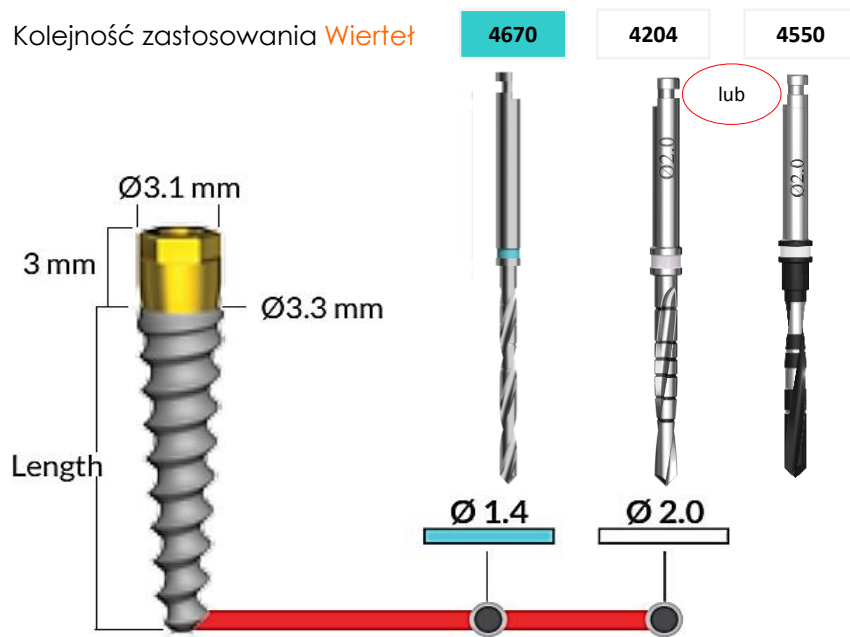

● Na całej długości wiertła

### Ważne!

W przypadku wiertła Ø 1.4 wysokość końcówki wiertła nie jest wliczona w długość wiertła. W przypadku wiertła Ø 2.0 wysokość końcówki wiertła jest wliczona w długość wiertła.

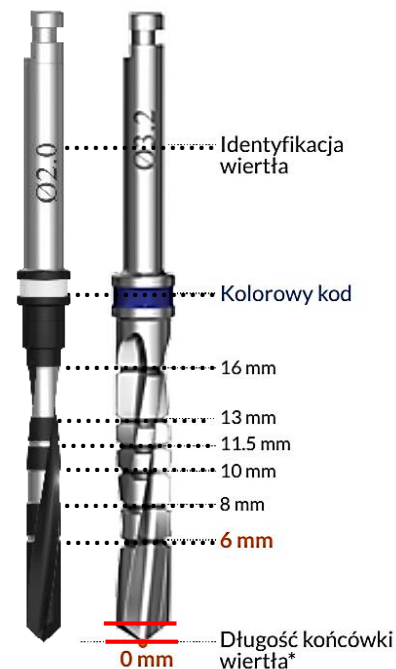

\* Długość wiertła jest mierzona od wierzchołka do znakowanej głębokości nawiercu